
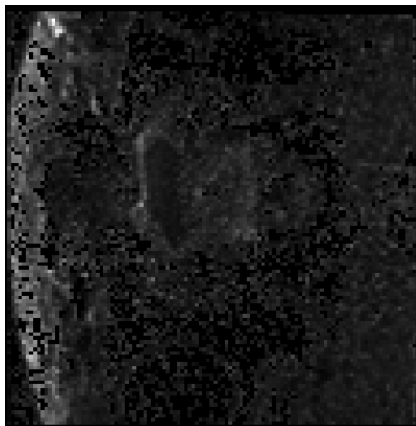


Muestra analizada

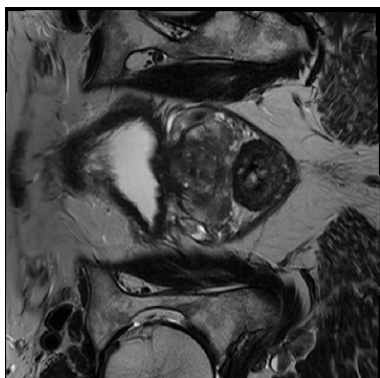


Muestra analizada

Nombre del paciente	Prueba		
Id del paciente	251218	Fecha del análisis	18/12/2025 09:42


Resultado del análisis en imagen DWI/ADC

Resultado	26.8	Umbral	XX.XX%
		PPV / NPV	XX.X% / XX.X%
		SENS / SPEC	XX.X% / XX.X%



Resultado del análisis en imagen T2W

Resultado	13.8 %	Umbral	XX.XX%
		PPV / NPV	XX.X% / XX.X%
		SENS / SPEC	XX.X% / XX.X%



Información legal

TEST DESCRIPTION: quantusPR™ ofrece una valoración automática del riesgo de cáncer de próstata a partir del análisis cuantitativo de las texturas de las imágenes T2W, ADC y DWI axiales de una resonancia. La calidad de la imagen y la adquisición son relevantes y se deben obtener considerando los requisitos del producto. En caso de duda o consulta sobre este informe puede ponerse en contacto con TRANSMURAL BIOTECH a través de la dirección de email support@quantuspr.org

quantusPR™ es un producto sanitario que cumple con la legislación vigente. Se considera quantusPR™ únicamente para el uso en investigación clínica y no para el uso clínico. quantusPR™ ha sido desarrollado por Transmural Biotech, B65084675, C/Juan Ignacio Luca de Tena 12, 28027 Madrid España. En virtud del Reglamento (UE) 2016/769 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, le informamos que Transmural Biotech es el encargado de tratamiento de sus datos con el fin de ofrecerle el tratamiento sanitario. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de datos y oposición y limitación a su tratamiento ante Transmural Biotech SL, en la dirección de correo electrónico dpo@transmuralbiotech.com


T2W - Cortes de mayor riesgo



13.8 %




13.3 %

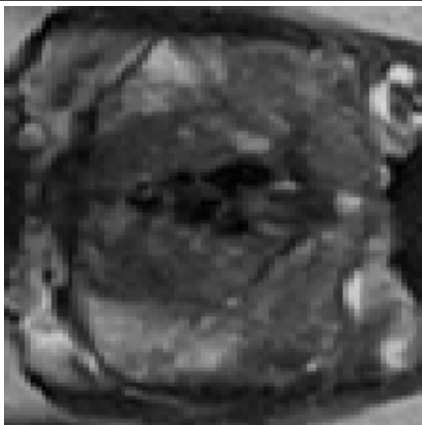


11.8 %


DWI/ADC - Cortes de mayor riesgo

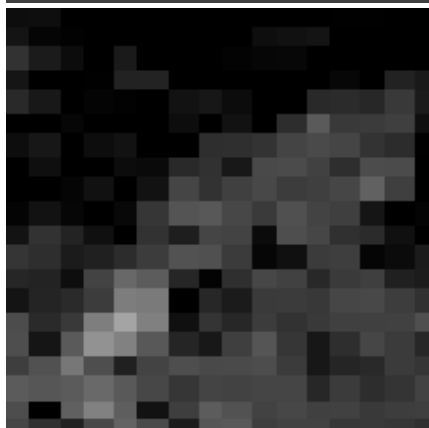

26.8 %

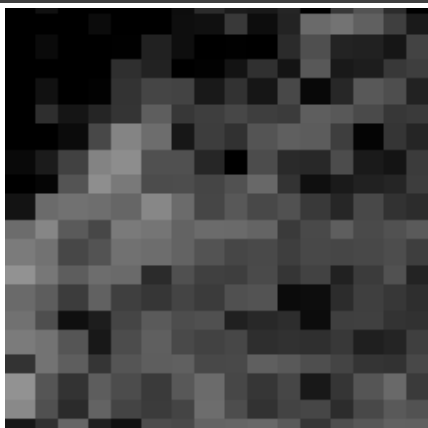

17.4 %

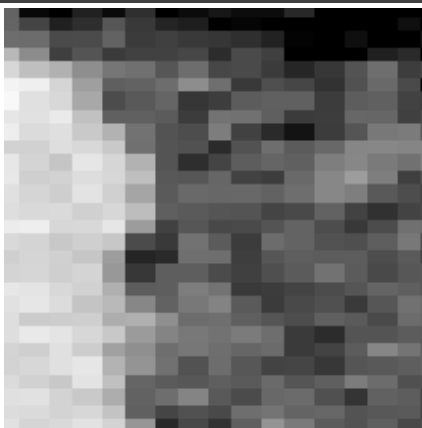

17.4 %

