



Información de la muestra

Microquistes (primeros 6 cortes de mayor confianza)

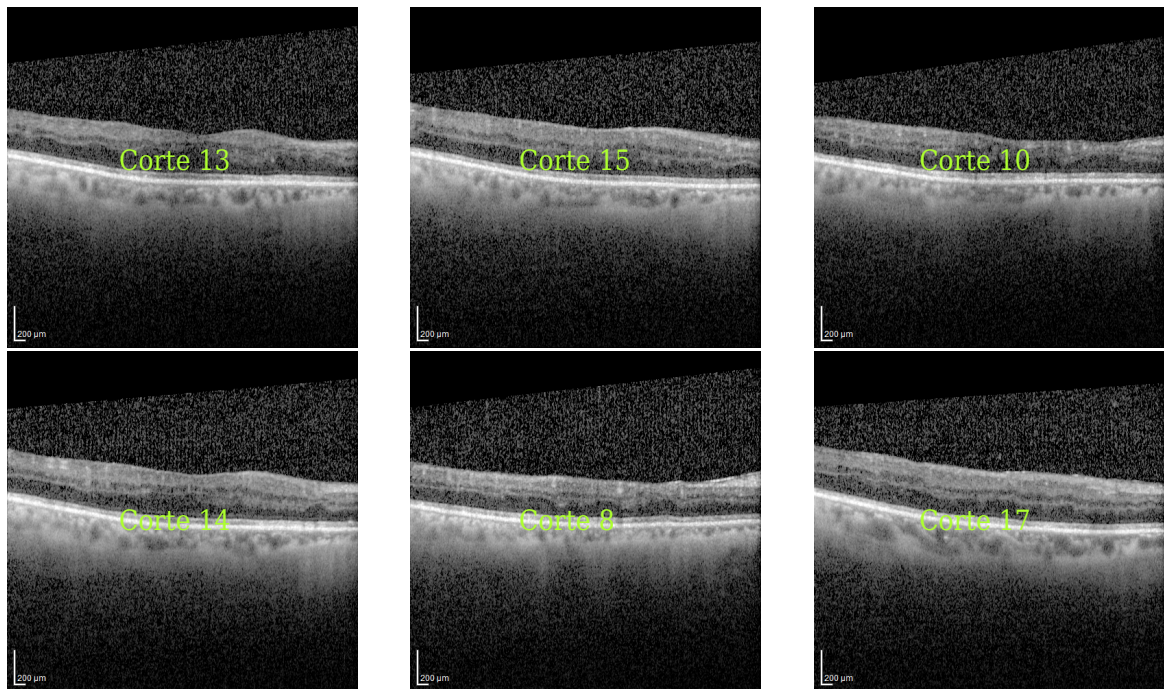

PHR (primeros 6 cortes de mayor confianza)

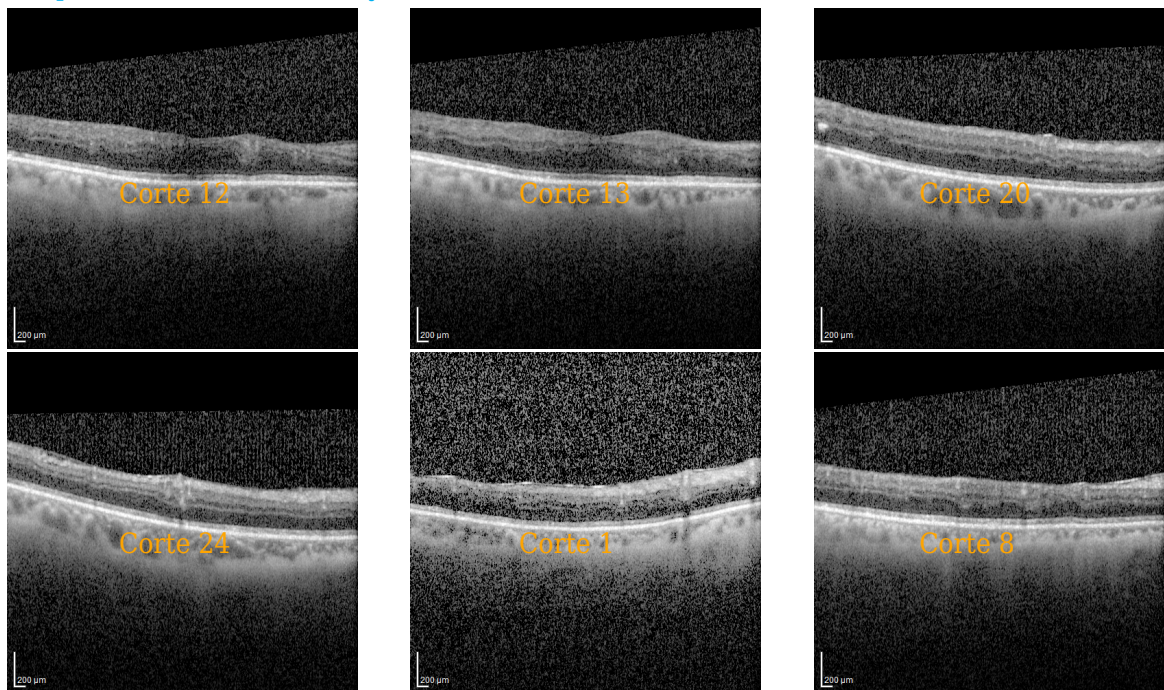

Paciente

NOMBRE:

test1

ID:

test1

FECHA DE ANALISIS:

24/01/2025

Resultado Informe

		Cortes *	Fecha
Microquistes	Análisis Actual	0/25	
	Análisis Previo	0/25	09/01/2025
PHR	Análisis Actual	9/25	
	Análisis Previo	9/25	09/01/2025

* Número de cortes de la OCT que sobrepasa el umbral establecido (XX,X%) definiendo éste como el valor para una sensibilidad del XX,X%, una especificidad del XX,X%, un VPP de XX,X% y un VPN de XX,X%

** Identificado en las imágenes en verde el número de corte en aquellas que el algoritmo predice no patológicas y en naranja aquellas que predice patológicas.

DESCRIPCION DEL TEST

quantusRT™ ofrece una valoración automática del riesgo de presencia de microquistes y puntos hiper-reflectantes a partir del análisis cuantitativo de las texturas del conjunto de imágenes de un OCT. La calidad de la imagen y la adquisición son relevantes y se deben obtener considerando los requisitos del producto. quantusRT™ se ha desarrollado para investigación clínica. Se considera quantusRT™ únicamente para el uso en investigación clínica y no para el uso clínico. quantusRT™ ha sido desarrollado por Transmural Biotech, B65084675, Juan Ignacio Luca de Tena 12 28027 Madrid, España. En virtud del Reglamento (UE) 2016/769 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, le informamos que Transmural Biotech es el encargado de tratamiento de sus datos con el fin de ofrecerle el tratamiento sanitario. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de datos y oposición y limitación a su tratamiento ante Transmural Biotech SL, en la dirección de correo electrónico dpo@transmuralbiotech.com